


Algoritmo de selección de pacientes



Micra™ VR y Micra™ AV

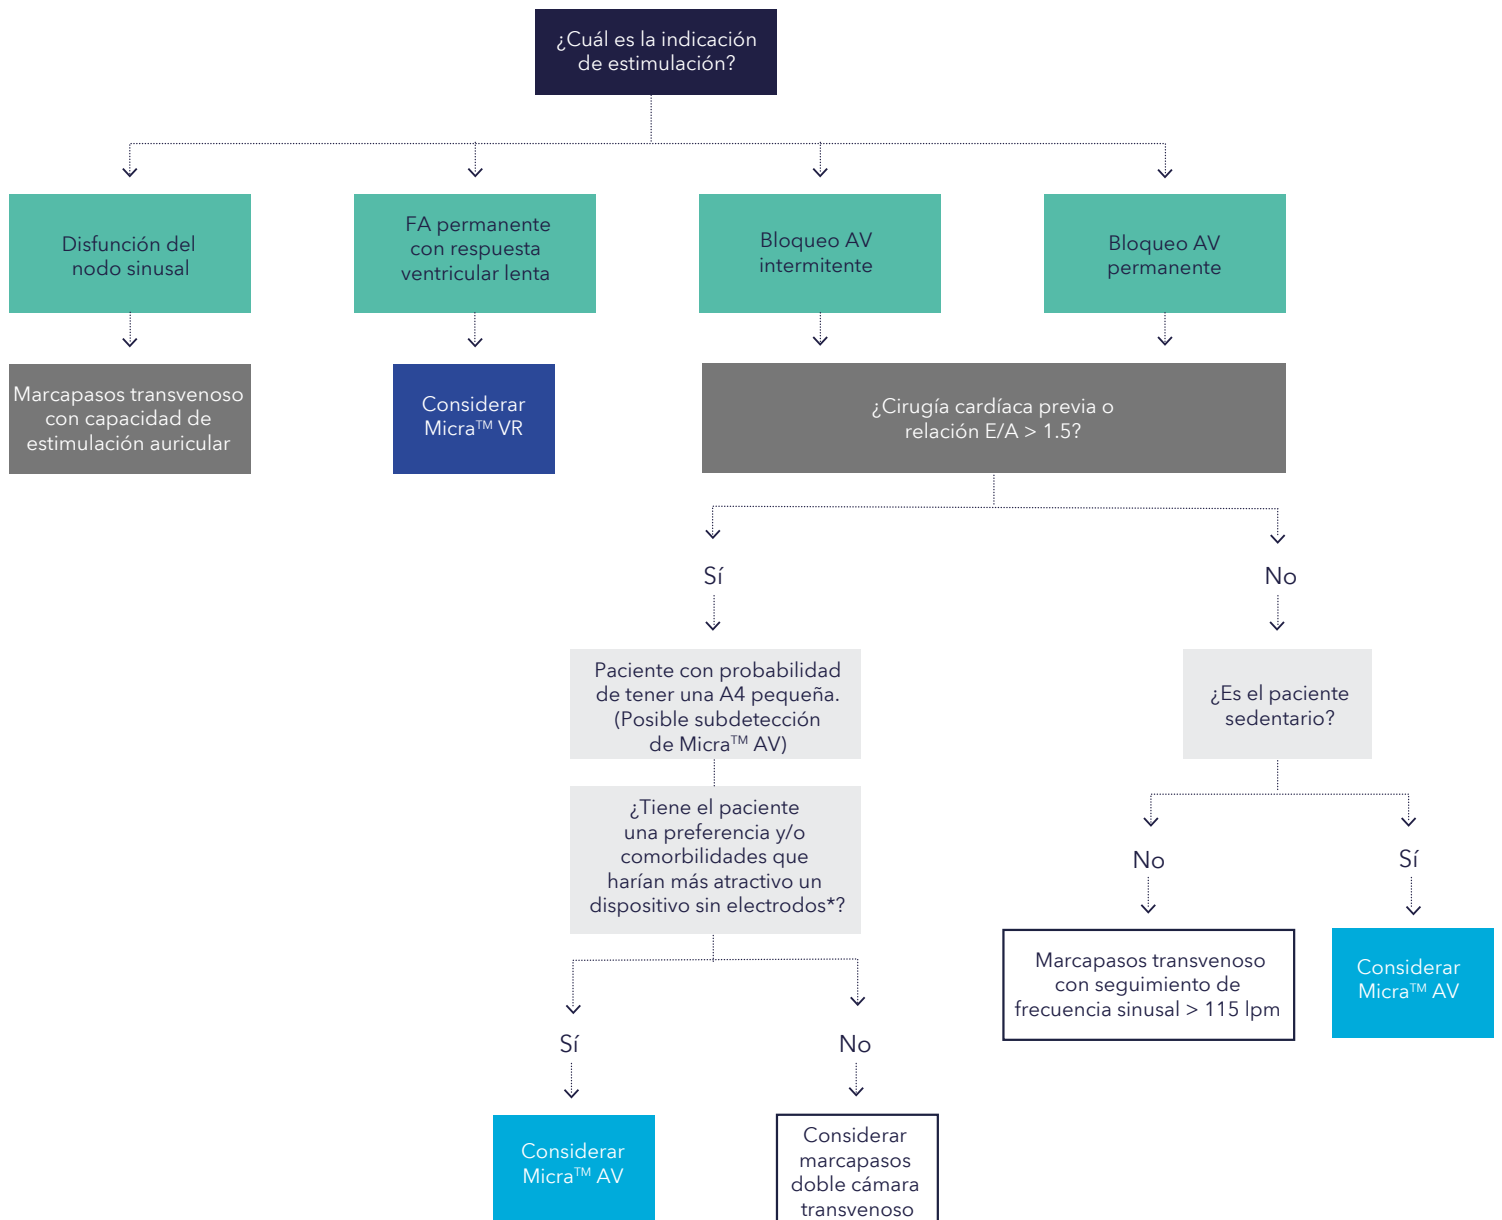

*Consideraciones para la selección de dispositivos sin electrodos:

- Necesidad infrecuente de estimulación
- Riesgo de infección
- Vasculatura superior desafiante o con necesidad de preservarla
- Edad avanzada
- Electrodo auricular considerado innecesario para una terapia eficaz
- Deterioro cognitivo
- Consideraciones sobre hábito corporal / preocupación por erosión del bolsillo

Para obtener información detallada acerca de las instrucciones de uso, el procedimiento de implante, las indicaciones, las contraindicaciones, las advertencias, las precauciones y los posibles eventos adversos, consulte el manual del dispositivo. Productos sanitarios con marcado CE conforme al Real Decreto 1616/2009. Si utiliza un dispositivo MRI SureScan®, consulte el manual técnico de MRI SureScan® antes de realizar una exploración por resonancia magnética. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Medtronic o consulte el sitio web de Medtronic en medtronic.com. Para los productos correspondientes, consulte las instrucciones de uso en www.medtronic.com/manuals. Los manuales se pueden consultar con una versión actual de cualquiera de los principales navegadores de internet. Para obtener mejores resultados, use Adobe Acrobat® Reader con el navegador.

Aviso importante

Esta información está destinada únicamente a los usuarios de los mercados donde los productos y las terapias de Medtronic están aprobados o disponibles para su uso, tal y como se indica en los manuales de los respectivos productos. El contenido sobre los productos y las terapias específicos de Medtronic no está destinado a los usuarios de los mercados en los que su uso no esté autorizado.

Indicaciones, seguridad y advertencias

Consulte el manual del producto en manuals.medtronic.com para obtener información detallada sobre el procedimiento de implante, las contraindicaciones, advertencias y precauciones, así como los posibles eventos adversos.



www.medtronic.com/manuals

Consulte el manual del producto en manuals.medtronic.com para obtener información detallada sobre el procedimiento de implante, las contraindicaciones, advertencias y precauciones, así como los posibles eventos adversos.

Medtronic

Latinoamérica

701 Waterford Way, Suite 190
Miami, FL 33126
786-709-4200

www.medtronic.com

UC202114841SL © 2022 Medtronic. Reservados todos los derechos. Medtronic, el logo de Medtronic y Otros, son en conjunto, marcas registradas de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas registradas de una compañía Medtronic. Covidien es una compañía que forma parte del grupo Medtronic.